Lenz

Tecnología Alemana

Garantía 3 AÑOS

Ficha Técnica

▷NB-206B

Nebulizador médico
Todo en 1

- Terapias domiciliarias
- Uso en el hogar
- Instituciones y hospitales

Único en el mercado con

Rango de presión

44-51 psi; 0.30 - 0.35 Mpa

G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS

Garantía 3 AÑOS

Es un equipo de uso continuo en **clínicas, hospitales** o **consultorios médicos.** Funciona bajo el concepto de la nebulización, donde el aire a presión se mezcla con el medicamento formando así una bruma de gotas microscópicas que puede inhalarse con facilidad.

44 - 51		1000h				
Psi	**Tecnología**	**Trabajo**	**Incluye kit**	**Con estuche**	**Para**	**Partículas**
de presión	anticalentamiento	continuo	de nebulización	tipo maletín	toda la familia	<0.5 - 5um (80%)

Tecnología alemana

El nebulizador institusional llegó para **revolucionar el mercado** con un **diseño y fabricación** innovadores, logrando **mayor rendimiento**

Mascarilla adulto y pediátrica en silicona

Tubo de aire en silicona

Copa dosificadora

Especificaciones Técnicas

Referencia	NB-206B
Fuente de alimentación	AC 110V/60HZ
Consumo de energía	≤ 70W
Dimensiones	180*205*100 mm
Rango de presión	44-51psi; 0.30-0.35 Mpa
Flujo de operación	12-16 LPM
Peso neto	1.45 Kg
Tasa de nebulización	0.25-0.30ml /min
Nivel de ruido	< 0.5-5um (80%)
Peso	< 53 dB (A)
Medicación	2-10 ml
Rango de temperatura de operación	10°C a 40°C (50°F A 104°F

¿ Qué incluye ?

1. Dispositivo
2. 5 filtros
3. 1 boquilla
4. 1 copa dosificadora
5. Mascarilla adulto y mascarilla pediátrica
6. Manual de usuario y empaque en portátil

Rango de humedad de operación	10% ~ 95% RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C-70°C (-4°F A 158°F

Partes del dispositivo

1. Mascarilla
2. Tubo de aire en silicona
3. Copa de medicación
4. Manilar de transporte
5. Botón de encendido y apagado
6. Aberturas de ventilación
7. Conector de salida de aire
8. Filtro y tapa de filtro
9. Soporte para copa o cámara

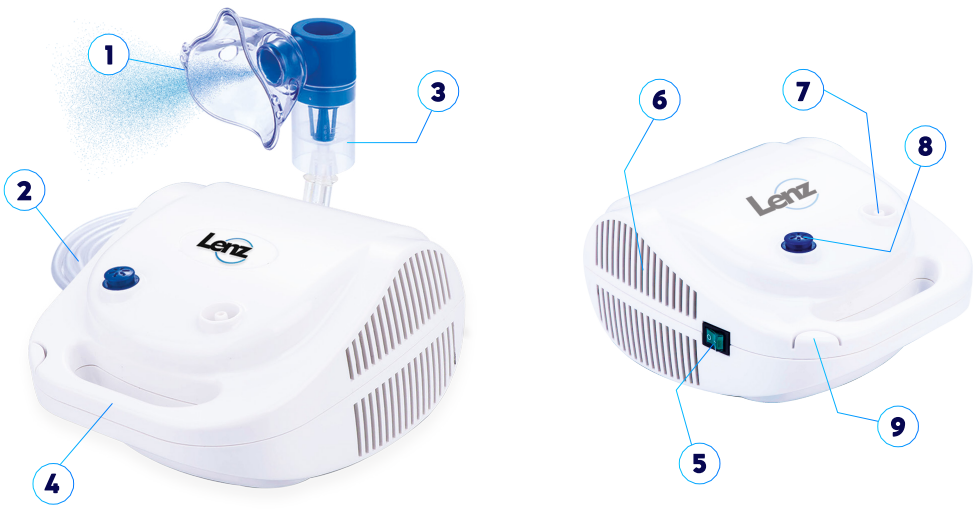

Mantenimiento

1. El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
2. El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal autorizado